HI98129 HI98130 HI98131
微电脑 pH-EC-TDS-°C/°F 测定仪

- 新款外观设计，超大双行屏幕显示 ，随屏校准操作步骤提示
- 人性化操作界面，稳定指示标识，两键式简单操作，操作便捷
- 同时测量显示 pH(EC/TDS) 和 °C/°F 测量，pH、EC、TDS 快速切换
- 自动识别校准，自动温度补偿，确保在不同环境下，测量精度和准确
- 电池更换简单快速，BEPS 低电量防错系统，避免错误测量
- 适用于在现场的环境下也可提供实验室级别的测量结果

		HI98129	HI98130	HI98131
测量范围	pH	0.00 to 14.00 pH		
	EC	0 to 3999 µS/cm	0.00 to 20.00 mS/cm	0.00 to 6.00 mS/cm
	TDS	0 to 2000 mg/L (ppm)	0.00 to 10.00 g/L (ppt)	0 to 3000 ppm (500 CF) 0 to 3999 ppm (700 CF)
	°C/°F	0.0 to 60.0°C、32.0 to 140.0°F		
校准点 @25°C		1-2 点自动识别校准，内置标准校准点：pH4.01、7.01、10.01；pH4.01、6.86、9.18		
		EC 单点：1413 µS/cm TDS 单点：1382 ppm (mg/L)	EC 单点：12.88 mS/cm TDS 单点：6.44 ppt (g/L)	EC 单点：5.00 mS/cm 或 1.41mS/cm HI5036 一键式快速校准
标配电极		HI73127 直插式聚丙烯酸度 pH 玻璃电极和内置 EC/TDS 电极及温度传感器 **温馨提示：**确保测量数据准确可靠，延长使用寿命，建议订购 HI7061 常规清洗液和 HI70300 电极保存液		

HI98128 HI98127 HI98121
微电脑 pH-ORP-°C/°F 测定仪

- 新款外观设计，超大双行屏幕显示 ，随屏校准操作步骤提示
- 人性化操作界面，稳定指示标识，两键式简单操作，操作便捷
- 同时测量显示 pH 和 °C/°F 测量，pH、ORP 快速切换【仅限 HI98121】
- 自动识别校准【ORP 出厂校准】，自动温度补偿
- 确保在不同环境下，测量精度和准确
- 电池更换简单快速，BEPS 低电量防错系统，避免错误测量
- 适用于在现场的环境下也可提供实验室级别的测量结果

		HI98128 pHep®5	HI98127 pHep®4	HI98121
测量范围	pH	-2.00 to 16.00 pH	-2.0 to 16.0 pH	-2.00 to 16.00 pH
	ORP	———	———	±1000 mV
	°C/°F	-5.0 to 60.0°C、23.0 to 140.0°F		
校准点 @25°C		1-2 点自动识别校准，内置标准校准点：pH4.01、7.01、10.01 和 pH4.01、6.86、9.18；ORP 默认出厂校准		
标配电极		HI73127 直插式聚丙烯酸度 pH 玻璃电极；内置铂金氧化还原电极【仅限 HI98121】 **温馨提示：**确保测量数据准确可靠，延长使用寿命，建议订购 HI7061 常规清洗液和 HI70300 电极保存液 HI98121 使用 HI7021 氧化还原标准液，如果测量值在 @25°C 240mV±50mV，说明电极正常 如果不在此范围，需使用 HI7091 或者 HI7092 进行氧化或还原处理至标准范围内		

HI98120 HI98201

微电脑氧化还原 ORP 测定仪

- HI98120 新款外观设计，超大双行屏幕显示
- 人性化操作界面，两键式简单操作，操作便捷
- 同时测量显示 ORP 和 °C/°F 测量
- 电池更换简单快速，BEPS 低电量防错系统，避免错误测量
- 适用于在现场的环境下也可提供实验室级别的测量结果

	HI98120	HI98201
测量范围	±1000 mV -5.0 to 60.0°C、23.0 to 140.0°F	±999 mV
校准模式	出厂默认校准	出厂默认校准
标配电极	HI73120 铂金氧化还原电极	内置铂金氧化还原电极
温馨提示	使用 HI7021 氧化还原标准液，测量值 @25°C240mV±50mV，电极正常， 不在范围，使用 HI7091 或者 HI7092 进行氧化或还原处理至标准范围内	

HI98107 HI98108 HI98118

微电脑 pH -°C/°F 测定仪

- 新款外观设计，超大双行屏幕显示，随屏校准操作步骤提示
- 人性化操作界面，稳定指示标识，两键式简单操作，操作便捷
- 同时测量显示 pH 和° C/° F 测量，自动识别校准
- 自动温度补偿，确保在不同环境下，测量精度和准确
- 电池更换简单快速，BEPS 低电量防错系统，避免错误测量
- 适用于在现场的环境下也可提供实验室级别的测量结果

		HI98107 pHep®	HI98108pHep®+	HI98118
测量范围	pH	0.0 to 14.0 pH	0.00 to 14.00 pH	
	°C/°F	0.0 to 50.0°C、32.0 to 122.0°F		
校准点 @25°C		1-2 点自动识别校准，内置标准校准点：pH4.01、7.01、10.01		
标配电极		内置酸度 pH 玻璃电极和温度传感器 **温馨提示**：确保测量数据准确可靠，延长多久使用寿命建议订购 HI7061 清洗液和 HI70300 电极保存液		

HI98100 HI98115 HI98103

微电脑酸度 pH 测定仪

- 具有大屏幕 LCD、自动识别校准，终点测量值稳定标识
- 屏幕将显示沙漏标识，测量读数稳定后，沙漏标识消失，即可读数
- 当电量不足时，显示电量不足标识，提示及时更换电池
- 可设置 8 分钟、60 分钟或者禁止三种模式自动关机功能
- 定制螺纹聚丙烯酸度 pH 玻璃电极，电极直径只有 8mm，效长度 103mm
- 微量样品或小瓶颈样品酸度快速测量，可替代酸度试纸

	HI98100 Checker®Plus HI98115	HI98103 Checker
测量范围	0.00 to 14.00 pH	0.0 to 14.0 pH
校准点 @25°C	1-2 点自动识别校准，内置标准校准点：pH4.01、7.01、10.01	
电源模式	CR2032 纽扣锂电池；手动设置 8 分钟、60 分钟或者禁用三种自动关机模式	
标配电极	HI1271 定制螺纹聚丙烯酸度 pH 玻璃电极，电极直径只有 8mm，效长度 103mm **温馨提示：**确保测量数据准确可靠，延长使用寿命，建议订购 HI7061 清洗液和 HI70300 电极保存液	

HI98103X 系列

量身定做行业专用 pH 测定仪

- 测量范围：0.00 to 12.00 pH；解析度 : 0.01 pH；精度 @25°C/77°F:±0.05 pH
- 具有大屏幕 LCD、自动单点或两点酸度【内置酸度标准校准点】识别校准
- 酸度 pH 电极诊断功能，在校准时，自动诊断酸度电极状态，显示屏出现 Err 错误信息时表示酸度电极需要进行清洗或者酸度电极已损坏
- 最终测量值稳定标识，在测量时屏幕将显示沙漏标识，测量读数稳定后，沙漏标识消失，即可读数
- 当电量不足时，显示电量不足标识，提示及时更换电池；仪器可设置 8 分钟、60 分钟或者禁止三种模式自动关机功能

HI981030 适用于农业、土壤行业酸度测量	
标配内置可填充聚偏二氟乙烯（PVDF）锥形电极，推荐填充液：HI9071	
满足农业、种植、园林等行业土壤酸度测试	
HI70663 土壤专用电极清洗	HI70664 腐殖质沉积物电极清洗液
HI70670 盐沉积电极清洗液	HI7051 专用土壤样品制备溶液
HI70300 常规电极保存液	HI9071 电极凝胶填充液，3.5M KCl+AgCl
温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液 用蒸馏水冲洗电极，将电极浸泡到专用电极清洗液中至少 15-20min 后取出电极， 再用蒸馏水冲洗电极后，将电极放入电极保存液中至少一个小时，方可再次使用。	



HI981031 适用于啤酒、麦芽汁行业酸度测量

标配内置钛合金机身玻璃平头酸度电极

符合 HACCP 食品管理体系认证，满足啤酒、麦芽汁等样品酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI70300 常规电极保存液	HI7061 常规电极专用清洗液

HI981032 用于奶酪、乳膏样品酸度测量

标配内置可填充聚偏二氟乙烯 (PVDF) 锥形电极，推荐填充液：HI9071

符合 HACCP 食品管理体系认证，满足奶酪、乳膏等样品酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI70642 奶酪沉积专用清洗液	HI70643 酸奶沉积物电极清洗液
HI70300 常规电极保存液	HI9071 电极凝胶填充液，3.5M KCl+AgCl

HI981033 适用于果汁、葡萄汁、葡萄酒行业酸度测量

标配内置防堵塞系统（CPS）可填充玻璃球形酸度电极

符合 HACCP 食品管理体系认证，满足果汁、葡萄酒等样品酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI70635 葡萄酒沉积物电极清洗液	HI70636 酒渍专用电极清洗液液
HI70300 常规电极保存液	HI7082 电极专用填充液，3.5M KCl

HI981034 适用于奶酪制造行业酸度测量

标配内置开放式接头设计玻璃锥形电极

符合 HACCP 食品管理体系认证，满足牛奶行业、奶制品等样品酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI70640 牛奶专用电极清洗液	HI70641 乳制品和消毒液专电极清洗液
HI70643 酸奶沉积物电极清洗液	HI70300 常规电极保存液

HI981035 适用于表面样品酸度测量

标配内置开放式接头设计玻璃平头电极，电极尺寸：110mm×∅12mm

符合 HACCP 食品管理体系认证，满足寿司、皮肤、皮革、纸张、乳液、琼脂和难以渗透的样品等表面酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI70621 皮肤润滑脂和皮脂电极清洗液	HI70681 墨渍电极清洗液
HI70682 酿造沉积物电极清洗液	HI70300 常规电极保存液

HI981036 适用于肉类行业酸度测量

标配内置可填充聚偏二氟乙烯（PVDF）锥形电极，推荐填充液：HI9071

符合 HACCP 食品管理体系认证，满足肉类行业、肉类产品等样品酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI70630 肉脂和脂肪酸性电极清洗液	HI70631 肉类油脂的碱性电极清洗液
HI70632 血制品和消毒液专电极清洗液	HI70300 常规电极保存液

HI981037 适用于皮肤表面样品酸度测量

标配内置开放式接头设计玻璃平头电极，电极尺寸：50mm×∅12mm

合 HACCP 食品管理体系认证，满足寿司、皮肤、皮革、纸张、乳液、琼脂和难以渗透的样品等表面酸度测试

温馨提示：确保数据可靠准确，延长电极使用寿命，建议订购电极专用清洗和保存液

HI70621 皮肤润滑脂和皮脂电极清洗液	HI700601 常规电极清洗液
HI700620 皮肤残留物清洗液	HI70300 常规电极保存液

HI98311 HI98312 HI98318

微电脑 EC-TDS-°C/°F 测定仪

- 新款外观设计，超大双行屏幕显示，随屏校准操作步骤提示
- 人性化操作界面，稳定指示标识，两键式简单操作，操作便捷
- 同时测量显示 EC/TDS 和 °C/°F 测量，EC 和 TDS 快速切换
- 自动识别校准，自动温度补偿，确保在不同环境下，测量精度和准确
- 电池更换简单快速，BEPS 低电量防错系统，避免错误测量
- 适用于在现场的环境下也可提供实验室级别的测量结果

		HI98311 DiST®5	HI98312DiST®6	HI98318
测量范围	EC	0 to 3999 µS/cm	0.00 to 20.00 mS/cm	0.00 to 6.00 mS/cm
	ORP	0 to 2000 mg/L (ppm)	0.00 to 10.00 g/L (ppt)	0 to 3000 ppm (500 CF) 0 to 3999 ppm (700 CF)
	°C/°F	0.0 to 60.0°C、32.0 to 140.0°F		0.0 to 50.0°C、32.0 to 122.0°F
校准点 @25°C		EC 单点：1413 µS/cm TDS 单点：1382 ppm (mg/L)	EC 单点：12.88 mS/cm TDS 单点：6.44 ppt (g/L)	EC 单点 :5.00 mS/cm 或 1.41mS/cm HI5036 一键式快速校准
标配电极		HI73311 直插式聚丙烯 EC/TDS 石墨电极及温度传感器		内置 EC/TDS 石墨电极及温度传感器

HI98331

微电脑土壤 EC -°C 测定仪

- 新款外观设计，超大双行屏幕显示，操作便捷
- 自动单点识别校准，自动温度补偿，确保测量高精度数据和测量数据可靠性
- 当电量不足时，显示电量不足标识，提示及时更换电池电池仪器可设置 8 分钟、60 分钟或者禁止三种模式自动关机功能
- 采用内置温度传感器可穿透式不锈钢电导电极（电极尺寸：114mm），无论在任何恶劣环境中，都可快速响应，得到准确的测量结果，适用于任何行业土壤电导率快速测定
- 符合国际及中国土壤电导测定电极法，专门适用于农业、环保等领域，用于直接土壤测量设计的笔试电导率 -EC、温度 °C 测定仪

测量范围	0 to 4000 µS/cm，0.00 to 4.00 mS/cm (dS/m) 0.0 to 50.0°C 、32.0 to 122.0°F
校准模式	自动识别单点校准，内置标准点 @25°C：1413µS/cm，推荐 HI7031
标配电极	内置温度传感器可穿透式不锈钢电导电极，电极尺寸：114mm

温馨提示：用蒸馏水冲洗电极，将电极浸泡到专用电极清洗液中至少 15 分钟后取出电极，再用蒸馏水冲洗电极后，方可再次使用。

HI98308　HI98309

微电脑超低量程电导率 EC 测定仪

- 新款外观设计，操作简单便捷，独特的两极石墨电极，电池更换简单，操作便捷
- HI98308 适用于实验室、脱矿水、工业环境的蒸馏水等测试领域
- HI98309 适用于高纯水等纯水测试领域

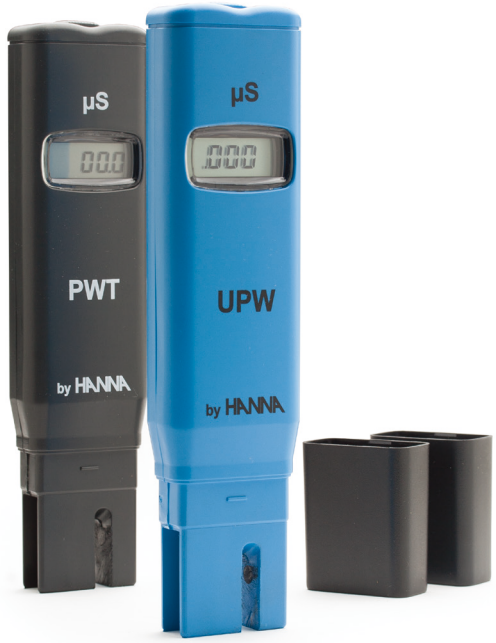

	HI98308 PWT	HI98309 UPW
测量范围	0.0 to 99.9 µS/cm	0.000 to 1.999 µS/cm
测量模式	单点校准：84µS/cm	出厂默认校准
温度补偿	自动温度补偿 0 to 50°C 补偿系数 ß = 2 % /°C	————

HI98303 HI98304

微电脑电导率 EC 测定仪

- 新款外观设计，操作简单便捷，独特的两极石墨电极电池更换简单，操作便捷
- 自动识别单点识别校准，自动温度补偿，确保测量高精度数据和测量数据可靠性
- 采用内置温度传感器和定制两极石墨电极，可快速响应，得到准确的测量结果
  适用于食品饮料、水处理、环境分析等不同行业

	HI98303 DiST®3	HI98304 DiST®4
测量范围	0 to 2000 µS/cm	0.00 to 20.00 mS/cm
	0.0 to 50.0ºC、32.0 to 122.0ºF	
校准模式	单点校准：1413 µS/cm	单点校准：12.88 mS/cm
温度补偿	自动温度补偿 0 to 50ºC（32.0 to 122.0ºF）	
温馨提示	确保测量读数准确性和可靠性，避免石墨电极堵塞或污染，使用完毕后，使用电极清洗液进行浸泡【推荐 HI7061】30 分钟左右清洗后，进行保存	

HI98301 HI98302

微电脑总固体溶解度 TDS 测定仪

- 新款外观设计，超大双行屏幕显示，操作便捷
- 自动识别单点识别校准，自动温度补偿，确保测量高精度数据和测量数据可靠性
- 采用内置温度传感器和定制两极石墨电极，可快速响应，得到准确的测量结果
- 适用于食品饮料、水处理、环境分析等不同行业

	HI98301 DiST®1	HI98302DiST®2
测量范围	0 to 2000 ppm(mg/L)	0.00 to 10.00 ppt(g/L)
	0.0 to 50.0ºC、32.0 to 122.0ºF	
校准模式	单点校准：1382 ppm	单点校准：6.44 ppt
温度补偿	自动温度补偿 0 to 50ºC (32.0 to 122.0ºF)；TDS 转换因子：0.5	
温馨提示	确保测量读数准确性和可靠性，避免石墨电极堵塞或污染，使用完毕后，使用电极清洗液进行浸泡推荐 HI7061】30 分钟左右清洗后，进行保存	